院内感染予防商材

アジア株式会社

銀系抗菌剤を配合した超音波ゼリーで菌を減らす

F JELLY PLUS
Ultrasound Gel

【販売元】 富士フイルムメディカル株式会社

SOFT
婦人科　産科

MIDDLE
消化器　乳腺

HARD
循環器　血管　整形

銀系抗菌剤を配合することにより、菌接触30分後には菌の99.99%以上が減少。プローブやゼリーボトルを介した感染リスクの低減が期待されます。

※ 本ゼリーは医薬品・医療機器ではなく、抗菌性能は医療用途としての認可を受けたものではありません。超音波装置の取扱説明書に従い、プローブの洗浄・消毒を行ってください。

抗菌性能試験

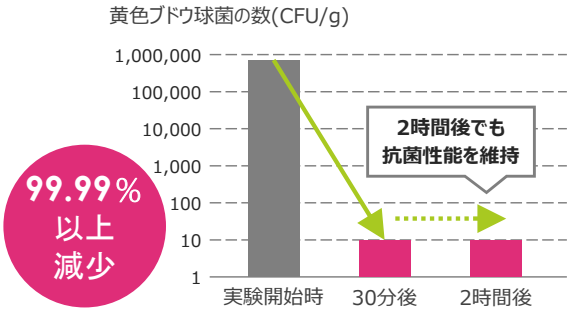

F JELLY PLUSの
菌接触後の生菌数
(作用温度:25±3℃)

北里環境科学センター
(試験番号:北生発26_0302号)

銀系抗菌剤の人体への影響

銀系抗菌剤について

- F JELLY PLUSで使用している銀系抗菌剤は、化粧品でも使われている材料です。
- お肌に異常があった場合にはご使用を中止してください。
- 銀は金属アレルギーになりにくい物質と言われています。

金属18種中、銀が最も陽性率が低かった

	健常者(1035人)		有病者(772人)	
	感作陽性率	順位	感作陽性率	順位
Hg(0.1%)	11.1%	1	19.3%	1
Ni(5%)	4.2%	6	18.3%	2
Cr	5.1%	5	14.5%	3
Fe	1.9%	10	2.1%	18
Mn	0.3%	19	1.2%	19
Ag	**0.1%**	**20**	**0.1%**	**20**
平均	3.9%		8.4%	

- 文部省 科学研究費助成事業「金属アレルギーの疫学的調査ならびにその口腔内使用金属との関連性について」
- パッチテストによる金属アレルゲンに対する陽性者の調査
- 全国14施設にて実施
- 被験者 ① 健常者:皮膚粘膜あるいは全身性のアレルギー疾患の自覚症状なし
  ② 有病者:自覚症状ありまたは患者として来院

【参考データ】 J Jpn Prosthodont Soc,37:1127-1138,1993
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjps1957/37/6/37_6_1127/_article/-char/ja/

ボトル　容量 250g
1種×12本入り

ソフト　ミドル　ハード

詰替え用　容量 2kg
1種×4個入り（空ボトル2本付き）

ソフト　ミドル　ハード

スキンケアの研究から生まれた超音波ゼリー

肌に素早くなじむのに、使用後にはサッと拭きとれます。べたつき感が残らないので、検査後の不快感の軽減。さらに汗にも強く、水っぽくなりにくい新感覚のゼリーです。